


Cryopep



La cryogénie au service de l'hémostase

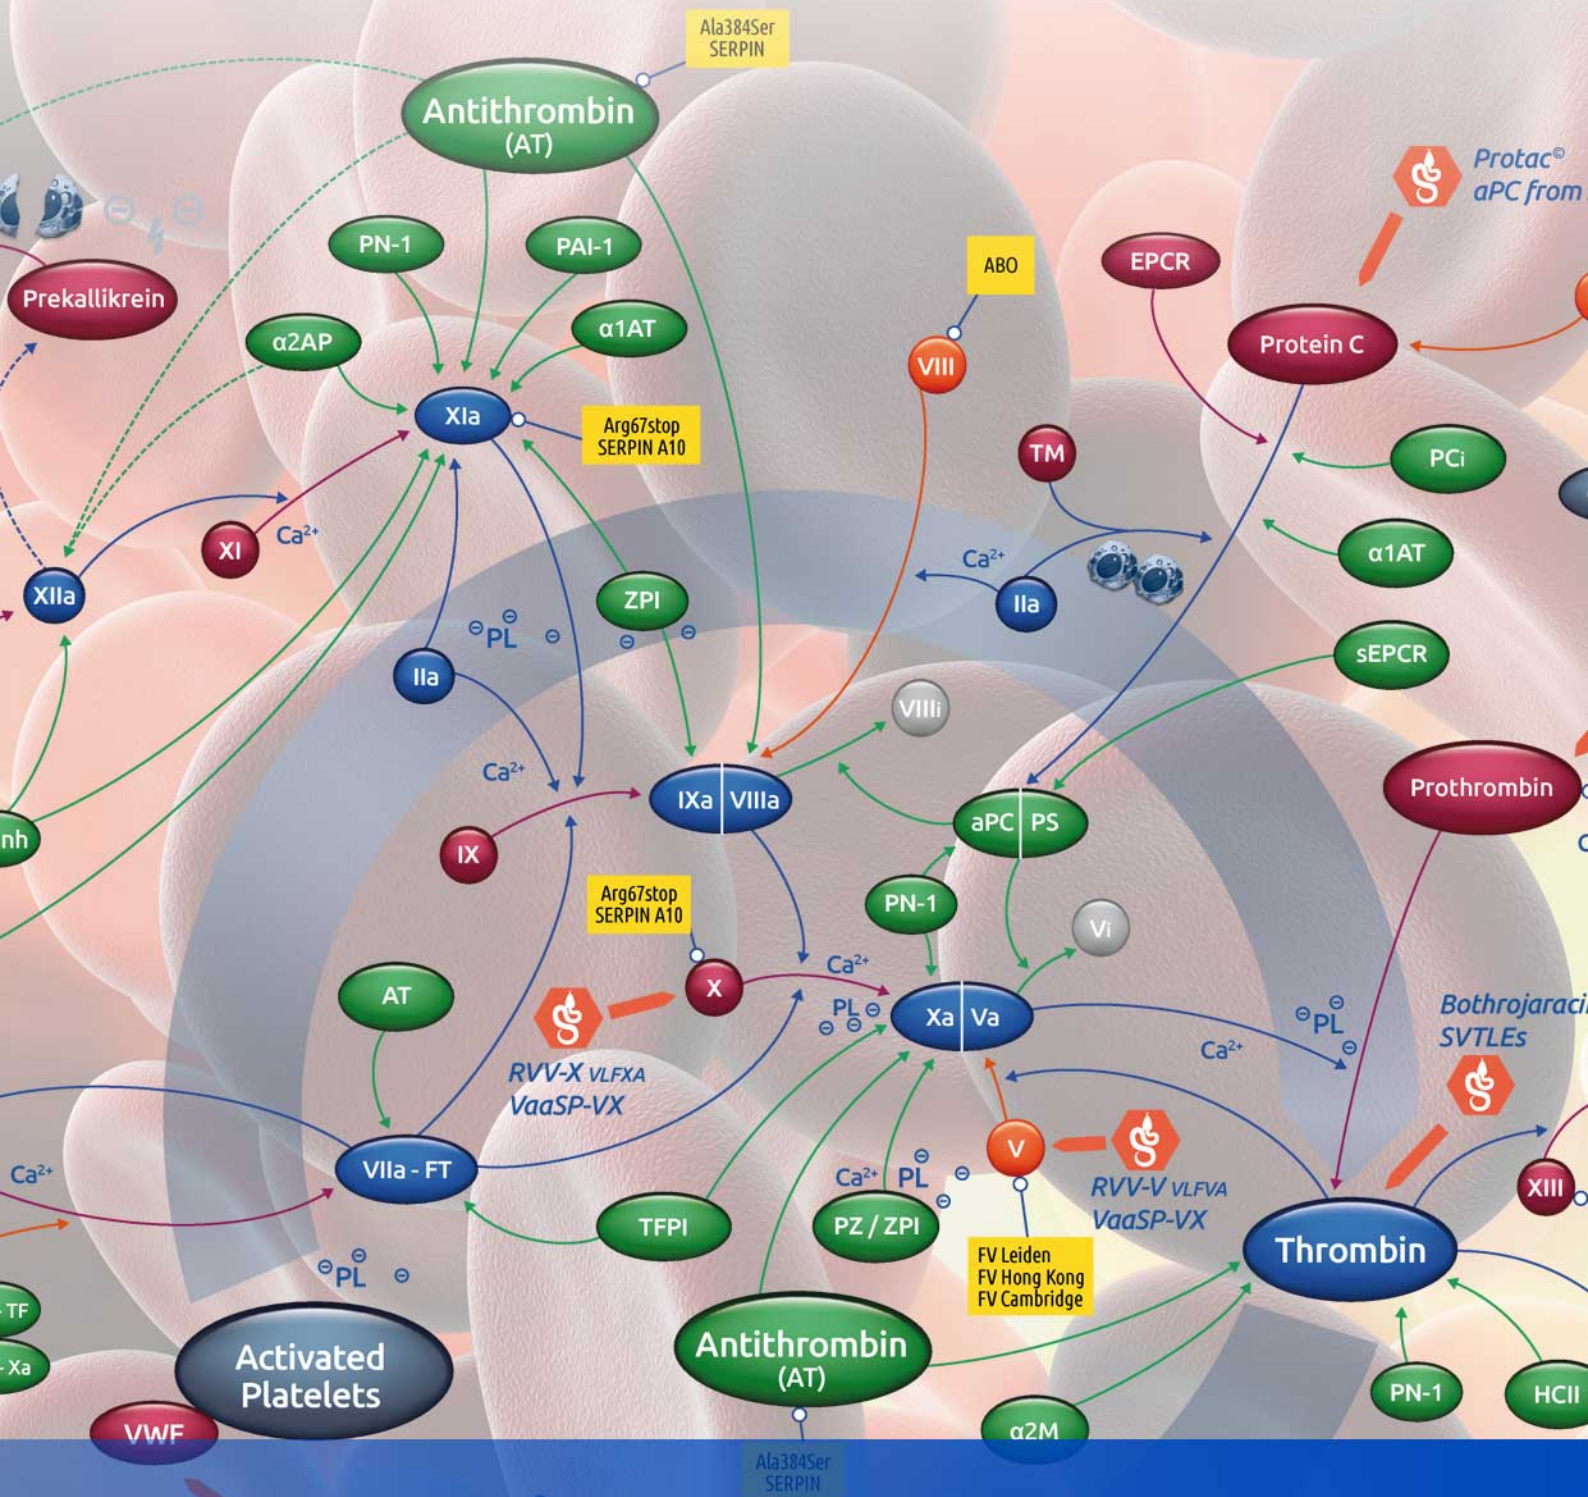

CALIBRATEURS ET CONTRÔLES LYOPHILISÉS

Edition du 2024-05-03 15:05:06

way

Endothelial Cells



Bilinuxin
Convulxin
Echicetin
EMS16

Mucetin
Rhodocytin
Sochicetin-A
Triwaglerin

CALIBRATEURS ET CONTRÔLES LYOPHILISÉS

CONTRÔLES SPÉCIALISÉS

Coagulation Control A



Ref	Format
4-5021055	5 x 1,0 mL
4-5021060	50 x 1,0 mL



Coagulation Control N



Ref	Format
4-5020040	5 x 1,0 mL
4-5020050	50 x 1,0 mL



Factor XIa Control



Ref	Format
5-1188	10 x 4,0 mL



Factor IXa Control



Ref	Format
5-9588	10 x 2,0 mL



EMICIZUMAB Controls



Ref	Format
6-152-401	2 x 5 x 1 mL



AVK

AK Verification Kit



Ref	Format
4-5010024	3 x 1,0 mL



AK-Calibrant



Ref	Format
4-5010004	4 x 1,0 mL



Coagulation Control AK



Ref	Format
4-5011050	5 x 1,0 mL
4-5011060	50 x 1,0 mL



CONTRÔLES DE ROUTINE

TECHNOCLOT® Control N



Ref	Format
4-5020070	10 x 1,0 mL
4-5020075	50 x 1,0 mL



TECHNOCLOT® Control A



Ref	Format
4-5021070	10 x 1,0 mL
4-5021075	50 x 1,0 mL



CALIBRATEURS SPÉCIALISÉS

Coagulation Reference



Ref	Format
4-5220110	5 x 1,0 mL
4-5220120	50 x 1,0 mL



Factor XIa Calibrator



Ref	Format
5-1199	10 x 4,0 mL



Factor IXa Calibrator



Ref	Format
5-9599	10 x 2,0 mL



EMICIZUMAB Calibrator



Ref	Format
6-151-201	5 x 1 mL



LÉGENDE DES PICTOGRAMMES



Ces kits sont fabriqués en conformité avec la directive 98/79 CE pour les appareils de diagnostic in vitro. Seuls les produits marqués CE peuvent être utilisés pour des applications de diagnostic en Europe.



Ces kits sont destinés à usage diagnostique in vitro.



Ces kits sont destinés à la recherche uniquement et ne sont pas destinés à être utilisés pour les procédures de diagnostic.



Federal Drug Administration, la FDA valide des coffrets de diagnostic pour une utilisation de diagnostic in vitro aux États-Unis.



Produits à risque biologique



conservation entre 2 et 8° C



Réactif sous forme liquide



Réactif sous forme lyophilisée



Réactif sous forme congelée



Stabilité après ouverture à 2-8° C



Produits pouvant être recongelés



Stabilité 30 jours après recongélation à -20° C



Fabricant



Importateur



Distributeur

Votre commande

1

Pour commander, plusieurs possibilités

Par téléphone +33(0)4 67 10 71 20
Par fax +33(0)4 67 10 71 21
Par e-mail contact@cryopep.com
Par courrier CRYOPEP, 83 rue Yves Montand, 34 080 Montpellier, FRANCE

2

Traitement de votre commande

Nous emballons avec soin les produits congelés dans des boîtes isothermes avec de la carboglace ou des packs froids selon la nature du produit.

Afin d'optimiser les conditions de transport de nos produits, nous expédions nos colis sous carboglace uniquement du lundi au mercredi, sauf demande expresse du client.

Toutes les autres commandes concernant les produits lyophilisés sont expédiées du lundi au vendredi.

3

Nos transporteurs vous livrent

Nous travaillons exclusivement avec des transporteurs bénéficiant de certifications ISO 9001 et CERTIPHARM.

Garantie de livraison rapide de tous les produits.

Durant les phases de transport, nous suivons tous nos envois et téléphonons, au besoin, à nos clients afin de vérifier la bonne réception des colis au sein du laboratoire.

visitez notre site web : <https://www.cryopep.fr>